



Bettenwaage C315.4B.500.C-1

WM-002-0016

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,0QN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	500 kg
Zifferschritt [d]	200 g
Tarierbereich	-500 kg
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	LCD (hinterleuchtet)
Verpackungsgröße	390×820×360 mm
Nettogewicht	18,5 kg
Bruttogewicht	28 kg

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme	5 W
Akku-Betriebszeit	bis 8 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Gemäß den MDR-Vorschriften (Medical Device Regulation) ist diese Waage kein Medizinprodukt.



Additional fee for verification

Zubehör (Additional Fee)

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Displays

Displays

Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – Ethernet

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – USB

Konverter RS 232 – RS 485

Thermische Drucker

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• RLAB [WX-010-0080]


• R Panel [WX-010-0187]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts

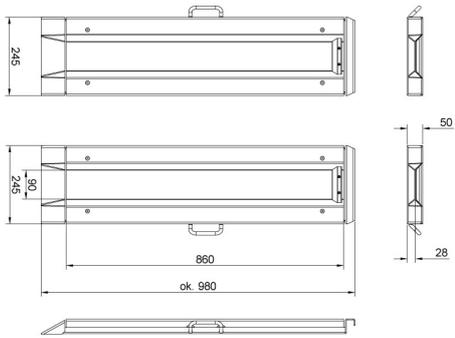

C315.8B

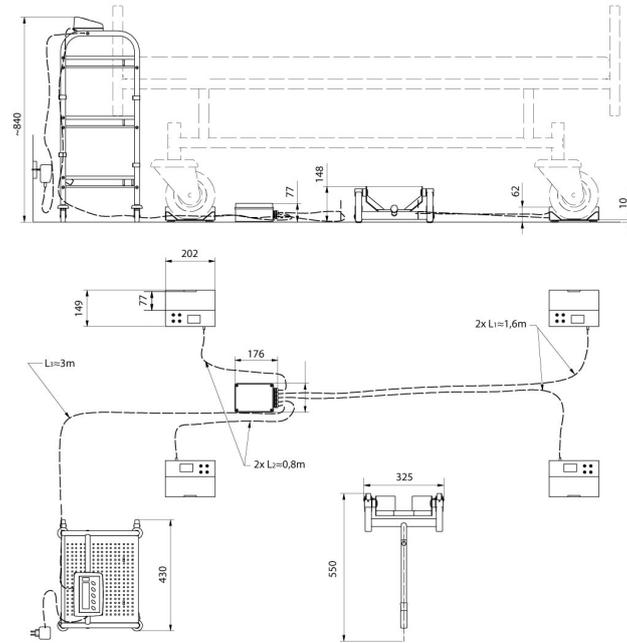

C315.4B