



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,0QN](http://radwag.com/es/info,w1,0QN)

# Balanza de cama C315.4B.500.C-1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Procedimientos GLP



Memoria Alibi



BMI

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	500 kg
Legibilidad [d]	200 g
Rango de tara	-500 kg
Clase OIML	III

### Parámetros físicos

Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensiones de embalaje	390x820x360 mm
Masa neta	18,5 kg
Masa bruta	28 kg

Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterías	hasta 8 horas
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Extra payment for verification

## Accesorios

Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Pantallas  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485


Convertidor RS 232 a Ethernet  
 Salidas del bucle de corriente AP2-1  
 Cables RS 232, RS 485  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Convertidor RS 232 a RS 485  
 Impresoras de recibos

## Programas


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

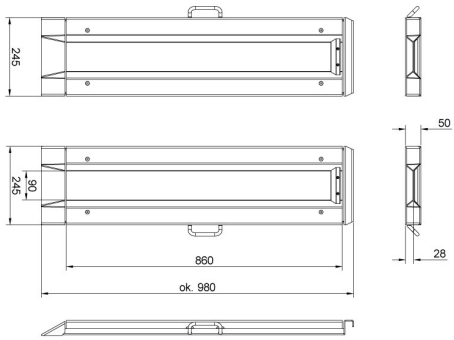

C315.8B

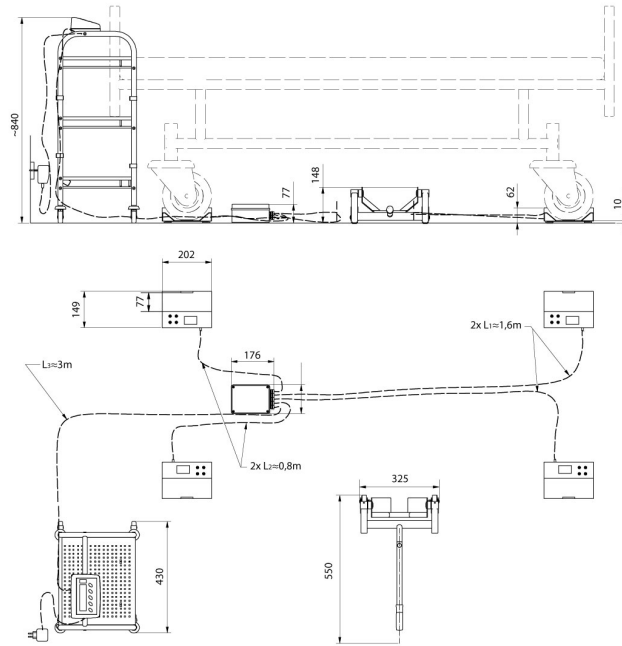

C315.4B