



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,0QN](http://radwag.com/pl/info,w1,0QN)

# Waga łózkowa C315.4B.500.C-1

WM-002-0016



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Wewnętrzny akumulator



Zatrząsk maksymalnego  
wskazania



Procedury GLP



Pamięć ALIBI



BMI

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	500 kg
Dokładność odczytu [d]	200 g
Zakres tary	-500 kg
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Wymiary opakowania	390×820×360 mm
Masa netto	18,5 kg
Masa brutto	28 kg

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 8 godzin
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

W świetle regulacji MDR ta waga nie jest wyrobem medycznym.



Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Wyświetlacze

Wyświetlacze

Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 – Ethernet

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 - USB

Konwerter RS 232 – RS 485

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]


• R-Panel [WX-010-0187]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia

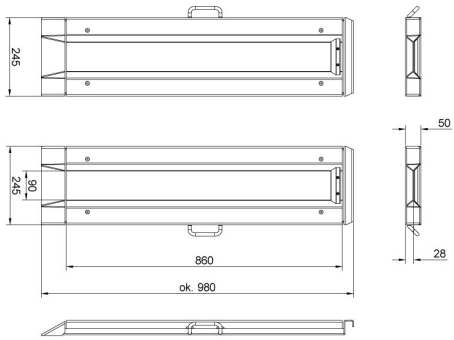

C315.8B

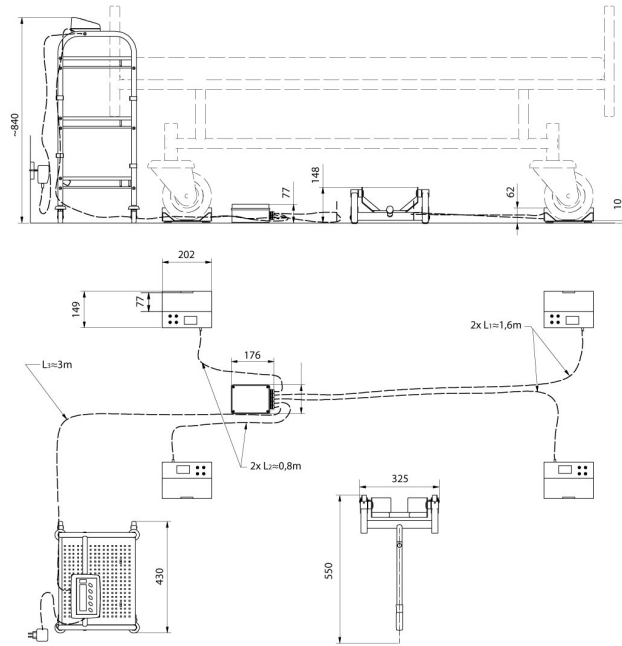

C315.4B